


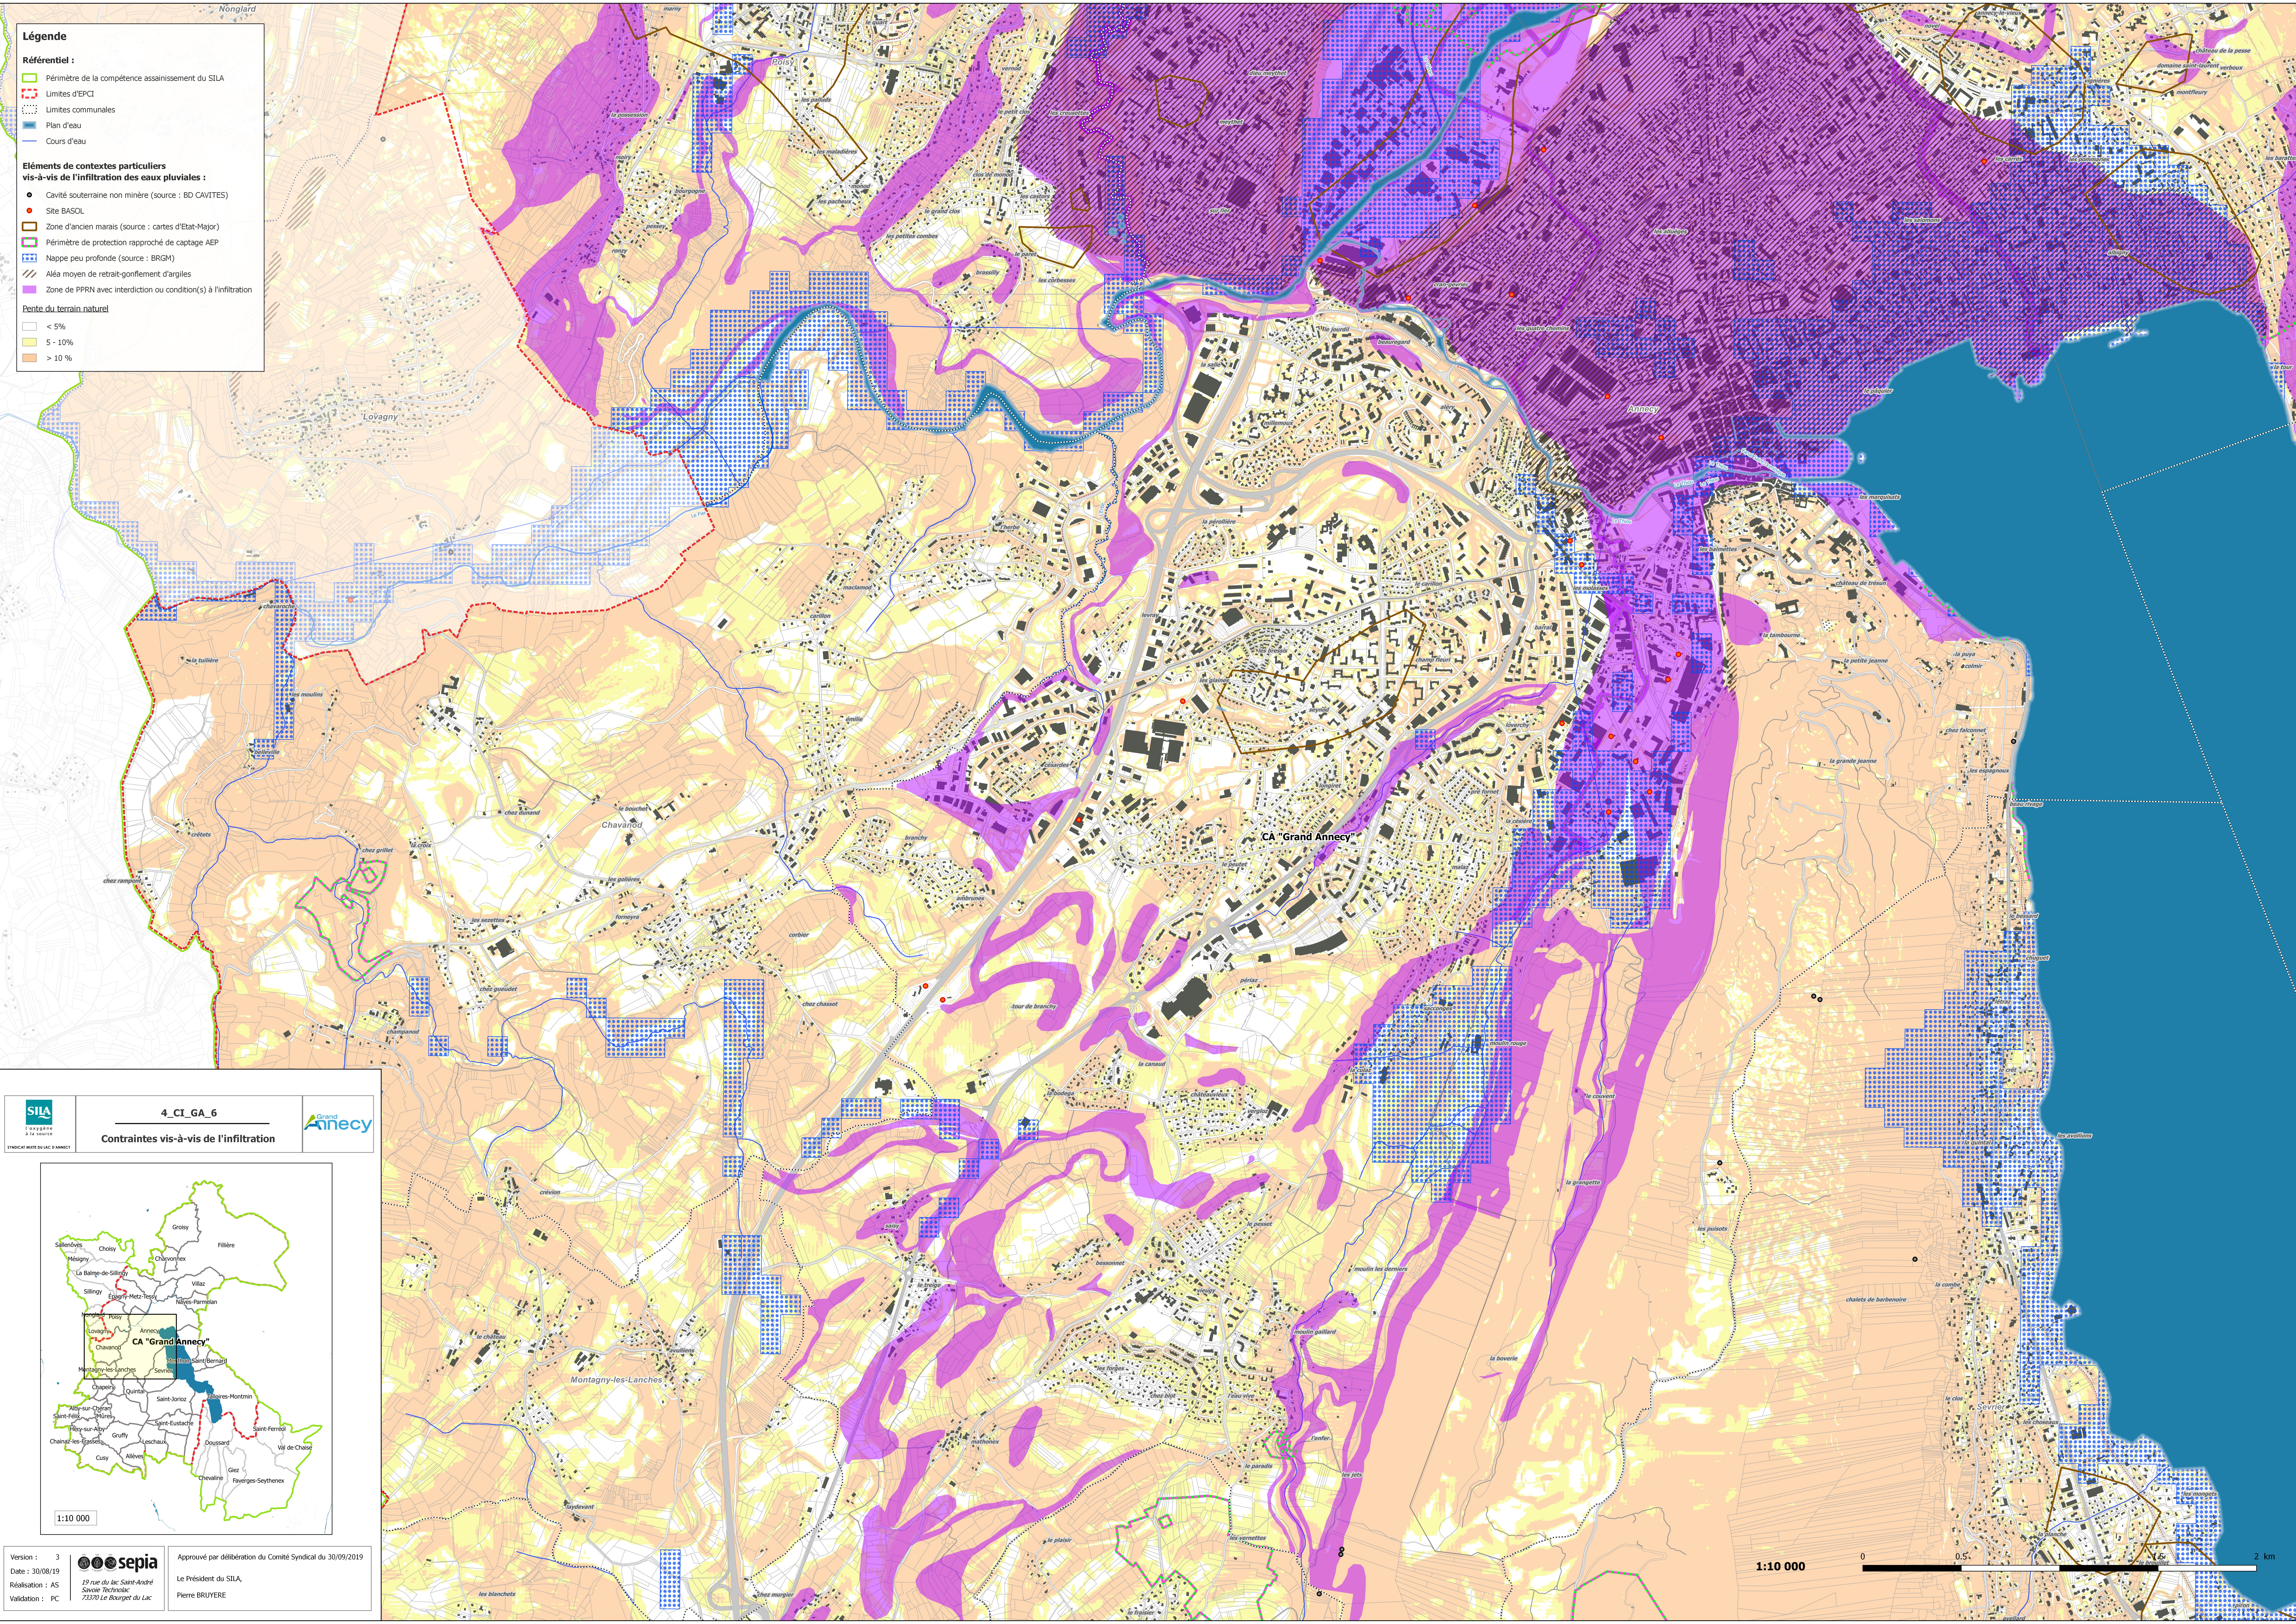

Légende

Référentiel :

Périmètre de la compétence assainissement du SILA

Limites d'EPCI

Limites communales

Plan d'eau

Cours d'eau

Eléments de contextes particuliers vis-à-vis de l'infiltration des eaux pluviales :

Cavité souterraine non minère (source : BD CAVITES)

Site BASOL

Zone d'ancien marais (source : cartes d'Etat-Major)

Périmètre de protection rapproché de captage AEP

Nappe peu profonde (source : BRGM)

Aléa moyen de retrait-gonflement d'argiles

Zone de PPRN avec interdiction ou condition(s) à l'infiltration

Pente du terrain naturel

< 5%

5 - 10%

> 10 %

4_CI_GA_6

Contraintes vis-à-vis de l'infiltration

Version : 3

Date : 30/08/19

Réalisation : AS

Validation : PC

19 rue du lac Saint-André
Savoie Technolac
73370 Le Bourget du Lac

Approuvé par délibération du Comité Syndical du 30/09/2019

Le Président du SILA,
Pierre BRUYERE

1:10 000

0 0.5 1 2 km

1:10 000